

【お詫びと訂正】

『ICU デイジーズ クリティカルケアにおける看護実践 改訂第2版』におきまして誤りがございました。

お詫び申し上げますとともに、以下のように訂正いたします。

p.231 9行目

(誤) 動脈圧モニターの観察では、前述した3つの絶対値 (SBP, DBP, SBP) 以外にも、波形からも読み取れる情報が多く含まれている。


(正) 動脈圧モニターの観察では、前述した3つの絶対値 (SBP, DBP, MBP) 以外にも、波形からも読み取れる情報が多く含まれている。

p.231 図4

(誤)

図4 ■ 正常動脈圧波形の意義および代表的な異常波形

①正常な動脈圧波形

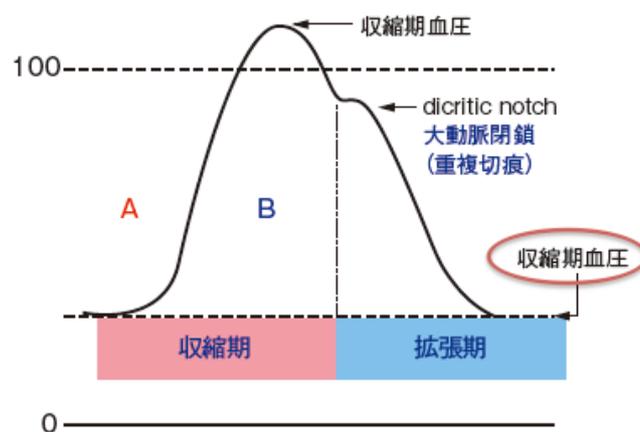

(正)

図4 ■ 正常動脈圧波形の意義および代表的な異常波形

①正常な動脈圧波形

