


正誤表

「糖尿病看護ビジュアルナーシング」におきまして、誤りがございました。
 謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のように訂正いたします。

学研メディカル秀潤社

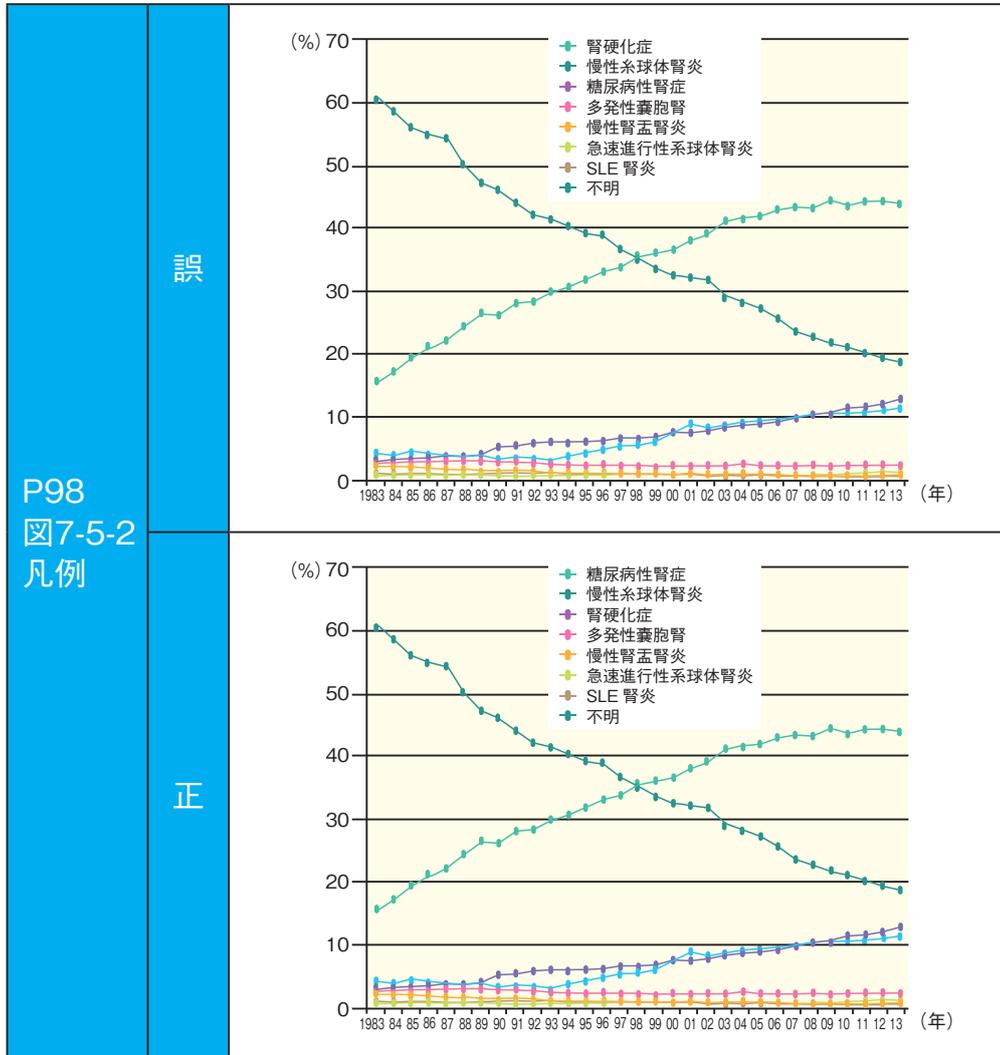

(2017年1月30日追記)

第1章 4 糖尿病の検査 P17	誤	$\text{HOMA-R} = \frac{\text{空腹時インスリン}(\mu\text{U/mL}) \times 360}{\text{空腹時血糖値}(\text{mg/dL})} - 63$
	正	$\text{HOMA-R} = \frac{\text{空腹時インスリン}(\mu\text{U/mL}) \times \text{空腹時血糖値}(\text{mg/dL})}{405}$