


## お詫びと訂正

『Clinical Engineering』2017年8月号 (Vol. 28, No. 8), 649ページの図3におきまして、編集上の誤りがありました。執筆者および読者の皆様に謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のように訂正いたします。

(2017年8月9日)

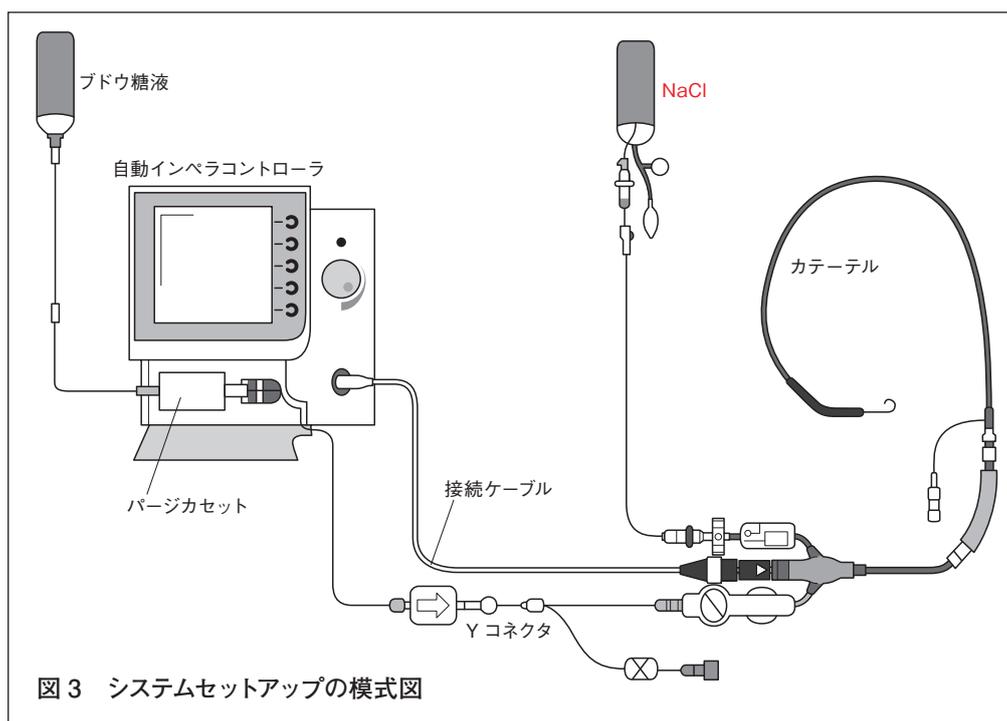

(学研メディカル秀潤社)