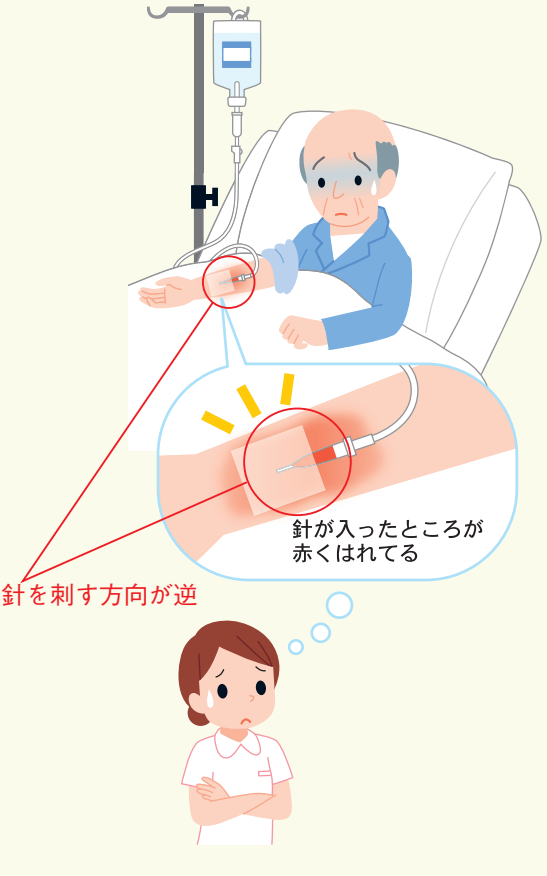
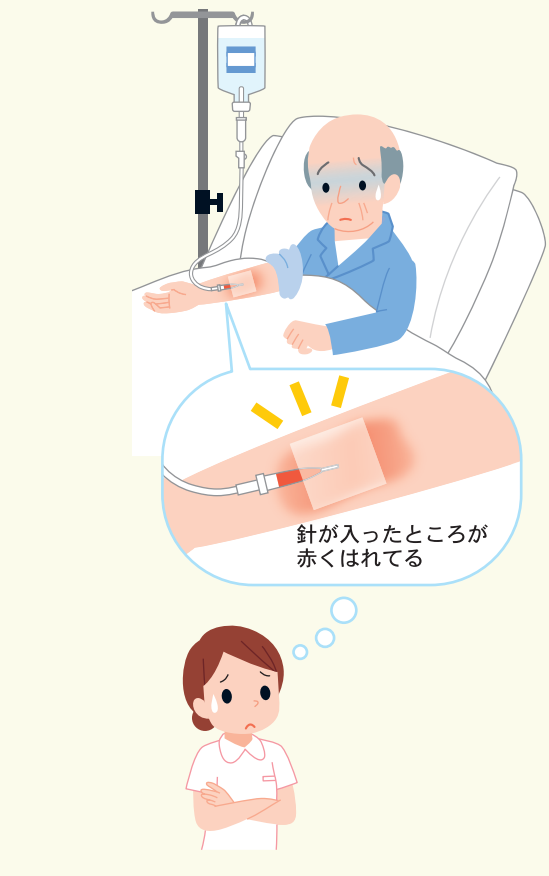


# 正誤表

「基礎と臨床がつながるバイタルサイン」におきまして、誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のように訂正いたします。

頁数	誤	正
<p>p.92,94 イラスト (※初版第2刷 では修正済)</p>	 <p>針が入ったところが赤くはれてる</p> <p>針を刺す方向が逆</p>	 <p>針が入ったところが赤くはれてる</p>
<p>p.18 図9</p>	<p>①補聴器</p>	<p>①聴診器</p>
<p>p.47 下から8行目</p>	<p>60回/分以下を徐脈</p>	<p>60回/分未満を徐脈</p>
<p>p.73 表1“口腔”の “適応外”</p>	<p>精神障害</p>	<p>意識障害</p>
<p>p.81 図11“波状熱”</p>	<p>1℃下がり</p>	<p>1度下がり</p>
<p>p.103 図6下の 吹き出し内</p>	<p>呼気には横隔膜が…(中略)… 空気に押し出されます。</p>	<p>呼気には横隔膜が…(中略)… 空気が押し出されます。</p>
<p>p.115 column〈持ち 方のコツ〉</p>	<p>“母指と示指でチェストピースを支える”と “チューブの根元を持つ”のイラストが逆</p>	